



GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Bd. Libertății nr. 14, București 5

Telefon 021 316 34 76

Fax 021 316 14 36

Operator date cu caracter personal nr. 35647/34744

AUTORIZAȚIE
PENTRU
DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. VG 2191 / 2019

În temeiul art. 8 din Legea Nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, al Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică și al Normelor specifice de securitate radiologică,

Ca urmare a analizării documentației înregistrată la C.N.C.A.N. cu nr. 5703/30675 din 11.07.2019,

Constatând că sunt îndeplinite prevederile legale,

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

AUTORIZEAZĂ

REGIA AUTONOMĂ TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA
NUCLEARĂ

din Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1, Jud. Argeș, tel. 0248/213.400
persoană juridică înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu
nr. J3/1315/2013 și CUI 32306920

să
UTILIZEZE

instalația radiologică, în cadrul:

Laboratorului de CND X-E

din cadrul: **INSTITUTULUI DE CERCETĂRI NUCLEARE PITEȘTI ICN**

situat în: situat în: Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Jud. Argeș, tel. 0248/213.400

în conformitate cu documentația prezentată și prevederile impuse în anexele nr. 1 și 2 , care fac parte integrantă din prezenta autorizație.

Intră în vigoare la data de: 01.11.2019

Expiră la data de: 31.10.2024

PREȘEDINTE,
Rodin TRAIKU

ANEXA Nr. 1
la autorizația pentru desfășurarea de activități în domeniul
nuclear nr. VG 2191 / 2019
privind utilizarea instalațiilor radiologice

I. LIMITE:

1. INSTALAȚIE RADIOLOGICĂ:

Sursa de radiații nucleare			Instalația radiologică		
Tip și nr.	Emitător	Parametrii maximi	Felul Instalației	Modul de acționare	Seria
Generator	X	250 kV; 7 mA	ANDREX CMA 25/357	Telecomandă	54049/1987/2000

2. APARATURA DE CONTROL DOZIMETRIC:
-Debitmetru AKTINIA tip U.Y.M., seria 583

II. CONDIȚII:

1. Utilizarea instalației este permisă numai în interiorul incintei special amenajate.
2. Se vor efectua lucrările de mentenanță (întreținere și verificare) recomandate de producător cu periodicitatea prevăzută în manualul de service ale instalației radiologice și semestrial se vor verifica parametrii tehnici nominali și de securitate radiologică de către un operator autorizat de CNCAN pentru desfășurarea acestui tip de activitate, conform prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare. Buletinele de verificare periodică se vor păstra la utilizator pentru a fi prezentate, la cerere, organelor de control.
3. Titularul de autorizație are obligația să anunțe de îndată orice eveniment radiologic la Centrul de Notificare al CNCAN (telefon: 021-351 50 89, fax: 021-351 50 88).

III. PERSONALUL CU RESPONSABILITĂȚI:

Responsabil cu protecția radiologică:

- **DRAGOMIR VIOLETA - permis de exercitare nivel 2, nr. 73/2019**

IV. CATEGORIA DE RISC RADIOLOGIC: 1




ANEXA Nr. 2

la autorizația pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear nr. VG 2191/ 2019

1. Punctele în care se efectuează măsurătorile câmpurilor de radiații din zonele controlate și spațiile adiacente zonei controlate, în conformitate cu cerințele art. 17 din Normele de securitate radiologică privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante, publicate în Monitorul Oficial Partea I nr. 709 din 29.08.2019.
2. Măsurătorile se efectuează periodic, conform prevederilor art. 17 alin. (5) din Normele precizate la pct. 1.

RA TEN
ICN PITEȘTI
INSTITUTUL DE CERCETĂRI NUCLEARE
L6 CTC-END

Schita cu amplasarea punctelor de masura a eficacitatii ecranelor de protectie la Laborator de defectoscopie - "Unitatea Nucleara E" - ICN Pitesti

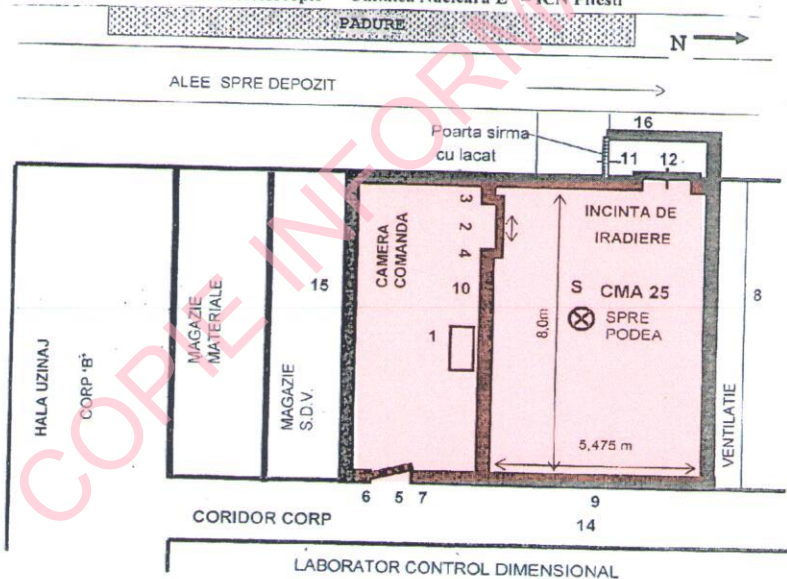

Nota: Amplasarea punctelor de masura este marcata cu cifrele 1+16

	Numele si prenumele	Funcția	Nivel de autorizare CNCAN	Semnatura	Data
Intocmit	Dragomir Violeta	responsabil cu protectia radiologica UN-E	2 -permis GR-CNDX Nr.73/ 2019		03.07.2019
Verificat	Toma Alexandru	expert in protectie radiologica	3 -permis ON si SD - spec.RN si AASD Nr.1010/2019		03.07.2019
Aprobat	Udroiu Victoria	Sef L6 CTC-END	1 -permis GR-CNDX Nr. E- 3789-2017		03.07.2019

